仕 様 書

競争に付する事項 ： ウォッシャーディスインフェクター　瑞西国ベリメド社製 WD290ND　1式

供給者は、本仕様書に基づき、物品を供給するものとする。

No.	品 名	コード	数量単位
1	ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ WD290ND,ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ,60Hz,ｽﾁｰﾑｺﾝﾃﾞﾝｻ・予熱ﾀﾝｸ付,(ﾀｲﾌﾟⅠ)	716-012-02	1 台
2	ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ ﾗｯｸﾄﾞﾗｲﾌﾞｾｯﾄ,50/60Hz(WD290ND)	716-012-07	1 台
3	ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ ﾛｰﾀﾞｰ,2 ﾗｯｸ用(WD290ND)右側ﾎﾞﾀﾝ	716-060-16	1 台
4	ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ ｱﾝﾛｰﾀﾞｰ,2 ﾗｯｸ用(WD290ND)左側ﾎﾞﾀﾝ	716-060-17	1 台
5	ﾍﾞﾘﾒﾄﾞ WD290 本体下部ﾊｶﾏ	716-060-08	1 個

１．本物品の納入期限は、令和２年１月 31 日とする。

２．物品の納入場所は、国立大学法人大阪大学歯学部附属病院とする。

３．本調達は、搬入、設置、調整、既設物品の撤去・廃棄の一切を含むものとする。

４．本物品の搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に、誤って建物等に損傷を与えた場合は、供給者の責任において修復または弁済を行うものとする。

５．搬入、設置、調整、既設物品の撤去の際に発生した雑芥の廃棄物は、供給者の責任において適正に処分するものとする。

６．搬入、設置、調整、既設物品の撤去の日程については、本学職員と協議のうえ定めるものとする。

７．その他詳細については、本学職員と協議のうえ定めるものとする。

設置条件等

（１）　本物品は、本学歯学部附属病院先端口腔総合診療棟２階中央材料室に設置すること。


（２）　一次側設備は本学において用意するので、二次側にかかる設備（給水・給湯・RO 水・排水・排気・電気設備）は供給者において用意し、接続調整を行うこと。

（３）　本物品設置後に清潔不潔側ともにパネル施工を実施すること。

（４）　既存物品１台を撤去・廃棄すること。

（５）　設置位置等に関しては、別紙図面どおりに設置すること。

別紙　図面

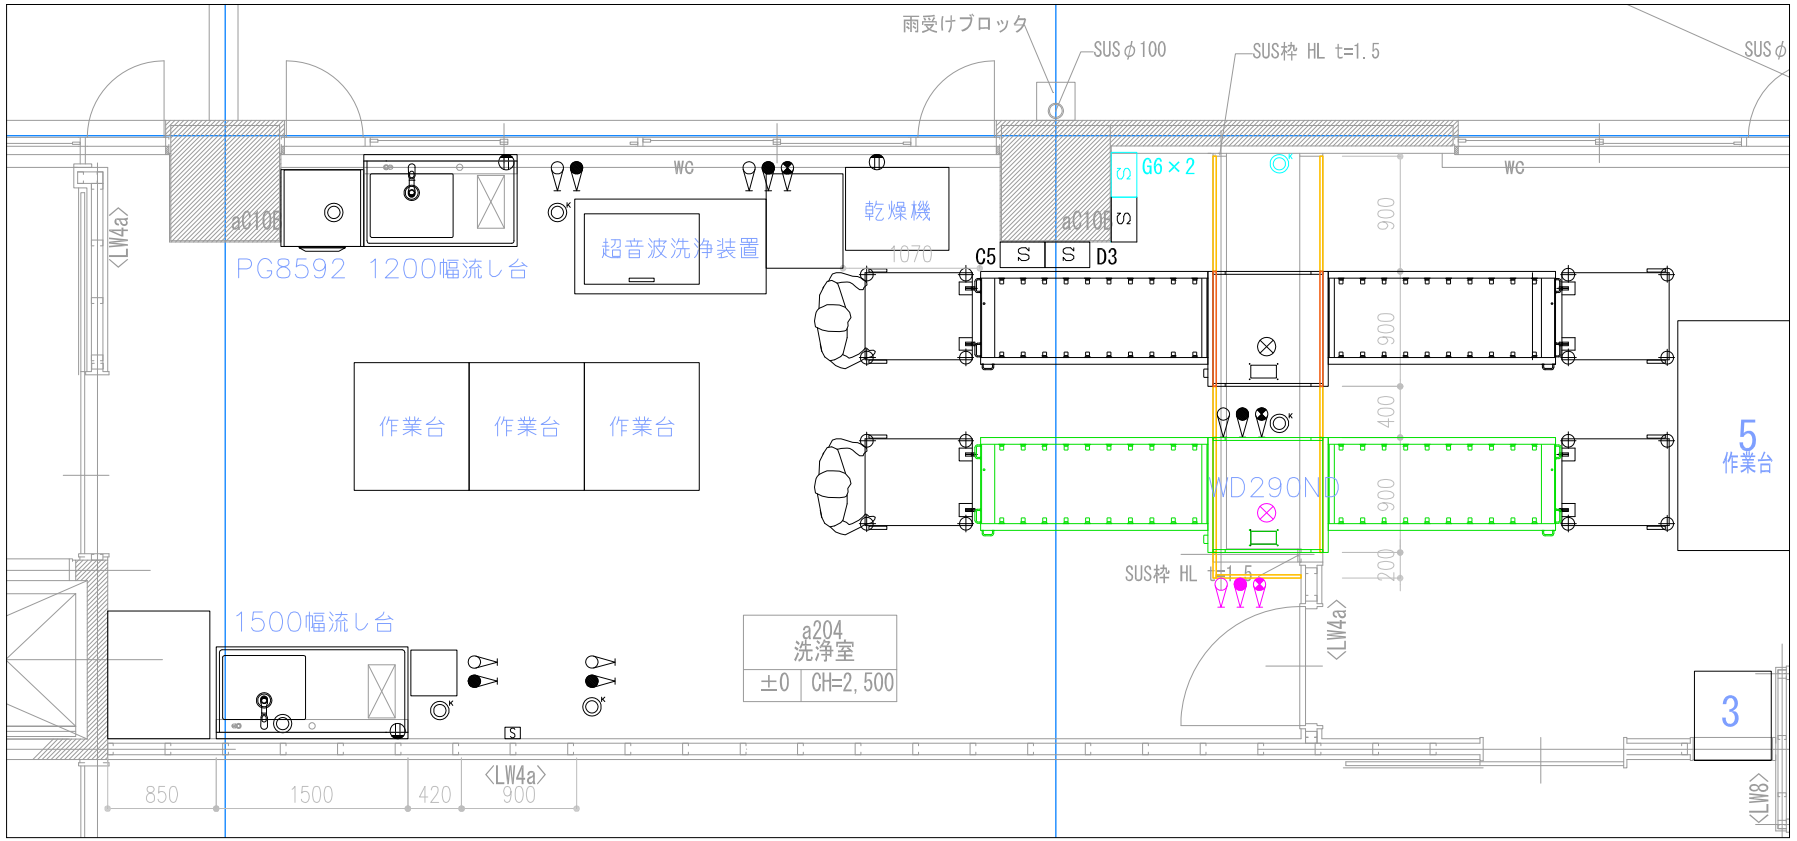

記号	品　名	品　番	重　量(kg)	放熱量(kcal/h)	機械寸法 W	D	H	台数
−	単槽式ウォッシャーディスインフェクター	WD290ND	本体重量：500 運転重量：約600	860	900	940	2215	1

種類	内　容	必要箇所
給水	SUS20A,FL+2400,立下り,バルブ止,P=0.2~0.6MPa,流量30L/min	1ヶ所
給湯	SUS20A,FL+2400,立下り,バルブ止,P=0.2~0.6MPa,流量30L/min,給湯温度60℃以下	1ヶ所
RO水	SUS20A,FL+2400,立下り,バルブ止,P=0.2~0.6MPa,流量30L/min,消費量40L/h	1ヶ所
高温排水	SGP50A,FL+50,キャップ止,排水温度最高93℃,背圧なきこと	1ヶ所
排気	SUS100φ以上,CH−100（FL+2400以上）,立下り,切放し,排気風量300m3/h,静圧350Pa 排気温度:最大90℃/平均70℃,湿度:最大100%/平均80%,継手部要シーリング	1ヶ所
電源 S	AC200V,3φ,60A,FL+1700（BOX下端）,漏電ブレーカー止,E付,消費電力21kW	1ヶ所
高温排水は高圧蒸気滅菌装置等の「排水・排蒸」とは別系統で施工願います。		